




INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-32/13
Broj: 1820-4
Datum: 13.06.2013. godine
Sremska Kamenica

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) komisija za javnu nabavku JN-32/13 – oksigenatori, obrazovana rešenjem direktora broj 1820-1/13 od 03.06.2013. godine sačinila je

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU JN-32/13 - OKSIGENATORI

I U delu konkursne dokumentacije 7) OBRAZAC PONUDE na strani broj 28/54, u opisu membranskog oksigenatora iz partije 1, u alineji 11 se ispred reči „držača oksigenatora i arterijskog filtera prema potrebama ustanove“ **dodaje broj 3**, a brišu se reči „prema potrebama ustanove“.

II U delu konkursne dokumentacije 7) OBRAZAC PONUDE na strani broj 29/54, u opisu membranskog oksigenatora iz partije 2, u alineji 11 se ispred reči „držača oksigenatora i arterijskog filtera prema potrebama ustanove“ **dodaje broj 2**, a brišu se reči „prema potrebama ustanove“.

III U delu konkursne dokumentacije 3)1) VRSTA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), na strani 8/54, **dodaje se nacrt seta linija sa arterijskim filterom i odgovarajućim sakerima**, koji je sastavni deo ovog dokumenta.

IV Izmena i dopuna konkursne dokumentacije će zajedno sa nacrtom seta linija i izmenjenim Obrascem ponude bez odlaganja biti objavljeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

1. Dr Mikloš Fabri, predsednik
2. Vesna Dunderski, zamenik člana
3. Tatjana Nikitović, dipl.pr., član



PONUDA br.: _____
Mesto izdavanja ponude: _____
Datum: _____
Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponude (ne može biti kraći od 30 dana): _____

PONUDA ZA: JN-32/13 OKSIGENATORI, Partija br.1 - MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE

Ponuđač:

Poslovno ime:			Matični broj:		
Adresa sedišta (ulica i broj):			Šifra delatnosti:		
Poštanski broj:	Grad:	Opština:	PIB:		
Telefon:	Fax:	Tekući račun:			
Adresa za prijem elektronske pošte:			Nosilac platnog prometa:		
Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vr. koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:					
Podaci o grupi ponuđača:					
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77 ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):					

Način davanja ponude (upisati): amotalno; -sa podizvođačem; - grupa ponuđača (zajednička ponuda))

Partija 1	MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE	POPUNJAVA PONUĐAČ						
R.br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Cena po JM bez PDV	Ukupna vrednost bez PDV-a	Komercijalni naziv	Originalno pakovanje	Proizvođač
1	<p>Membranski oksigenator sa "coating"-om uz set linija za odrasle (prema nacrtu IKVBV Sr. Kamenica) treba da poseduje sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oblogu "coating" na membrani koja čini fiziološki kontakt između krvi i strane površine sa posledničnim protektivnim efektom na trombocite i pad pritiska preko membrane - osobinu biokompatibilnosti materijala (koja treba da ublaži kontakt između krvi i strane površine) - maksimalan transfer kiseonika - mogućnost optimalnog uklanjanja ugljen-dioksida - minimalan pad pritiska preko membrane - integrisani izmenjivač toplote sa visokim koeficijentom razmene - jednostavnost u rukovanju i bezbednost u radu - arterijski filter i "pre-bypass" filter u sastavu linija - odvojeno upakovan set linija za operativni sto od linija za pumpu - set linija sa arterijskim filterom i sa odgovarajućim sakerima, prema nacrtu ustanove. - 3 držača oksigenatora i arterijskog filtera. 	kom	1000					

Podaci o izvršenju usluge i načinu plaćanja:

Rok isporuke:
Mesto isporuke:
Način i rok plaćanja:
Referenca:
Posebne napomene:

Ukupno bez PDV-a	
PDV:	
UKUPNO sa PDV-om:	
Slovima:	
Potpis i pečat:	

PONUDA br.: _____
Mesto izdavanja ponude: _____
Datum: _____
Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponude (ne može biti kraći od 30 dana): _____

PONUDA ZA: JN-32/13 OKSIGENATORI, Partija br.2 - MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE SA MALOM TELESNOM POVRŠINOM

Ponudač:

Poslovno ime:			Matični broj:		
Adresa sedišta (ulica i broj):			Šifra delatnosti:		
Poštanski broj:	Grad:	Opština:	PIB:		
Telefon:	Fax:	Tekući račun:			
Adresa za prijem elektronske pošte:			Nosilac platnog prometa:		
Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vr. koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:					
Podaci o grupi ponuđača:					
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77.ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):					

Način davanja ponude (**upisati**):

_____ samostalno; -sa podizvođačem; - grupa ponuđača (zajednička ponuda))

Partija 2	MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE SA MALOM TELESNOM POVRŠINOM			POPUNJAVA PONUĐAČ				
R.br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Cena po JM bez PDV	Ukupna vrednost bez PDV-a	Komercijalni naziv	Originalno pakovanje	Proizvođač
1	<p>Membranski oksigenator sa "coating"-om za odrasle osobe sa malom telesnom površinom uz set linija za odrasle osobe (prema nacrtu IKVBV Sr. Kamenica) treba da poseduje sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oblogu "coating" na membrani koja čini fiziološki kontakt između krvi i strane površine sa posledničnim protektivnim efektom na trombocite i pad pritiska preko membrane - osobinu biokompatibilnosti materijala (koja treba da ublaži kontakt između krvi i strane površine) - maksimalan transfer kiseonika - mogućnost optimalnog uklanjanja ugljen-dioksida - minimalan pad pritiska preko membrane - integrisani izmenjivač toplote sa visokim koeficijentom razmene - jednostavnost u rukovanju i bezbednost u radu - arterijski filter i "pre-bypass" filter u sastavu linija - odvojeno upakovan set linija za operativni sto od linija za pumpu - set linija sa arterijskim filterom i sa odgovarajućim sakerima, prema nacrtu ustanove. - 2 držača oksigenatora i arterijskog filtera. - oksigenator mora da podržava protok do 7 l/m sa površinom 1.5 m2 	kom	300					

Podaci o izvršenju usluge i načinu plaćanja:

Rok isporuke:
Mesto isporuke:
Način i rok plaćanja:
Referenca:
Posebne napomene:

Ukupno bez PDV-a: _____
PDV: _____
UKUPNO sa PDV-om: _____

Slovima: _____

Potpis i pečat: _____





TABLE PACK — Label



PACKAGING:




Peel Pouch

Perfusion Tubing Systems



INSTITUTE OF CARDIOVASCULAR
DISEASES VOJVODINA
Sremska Kamenica, Republic of SERBIA

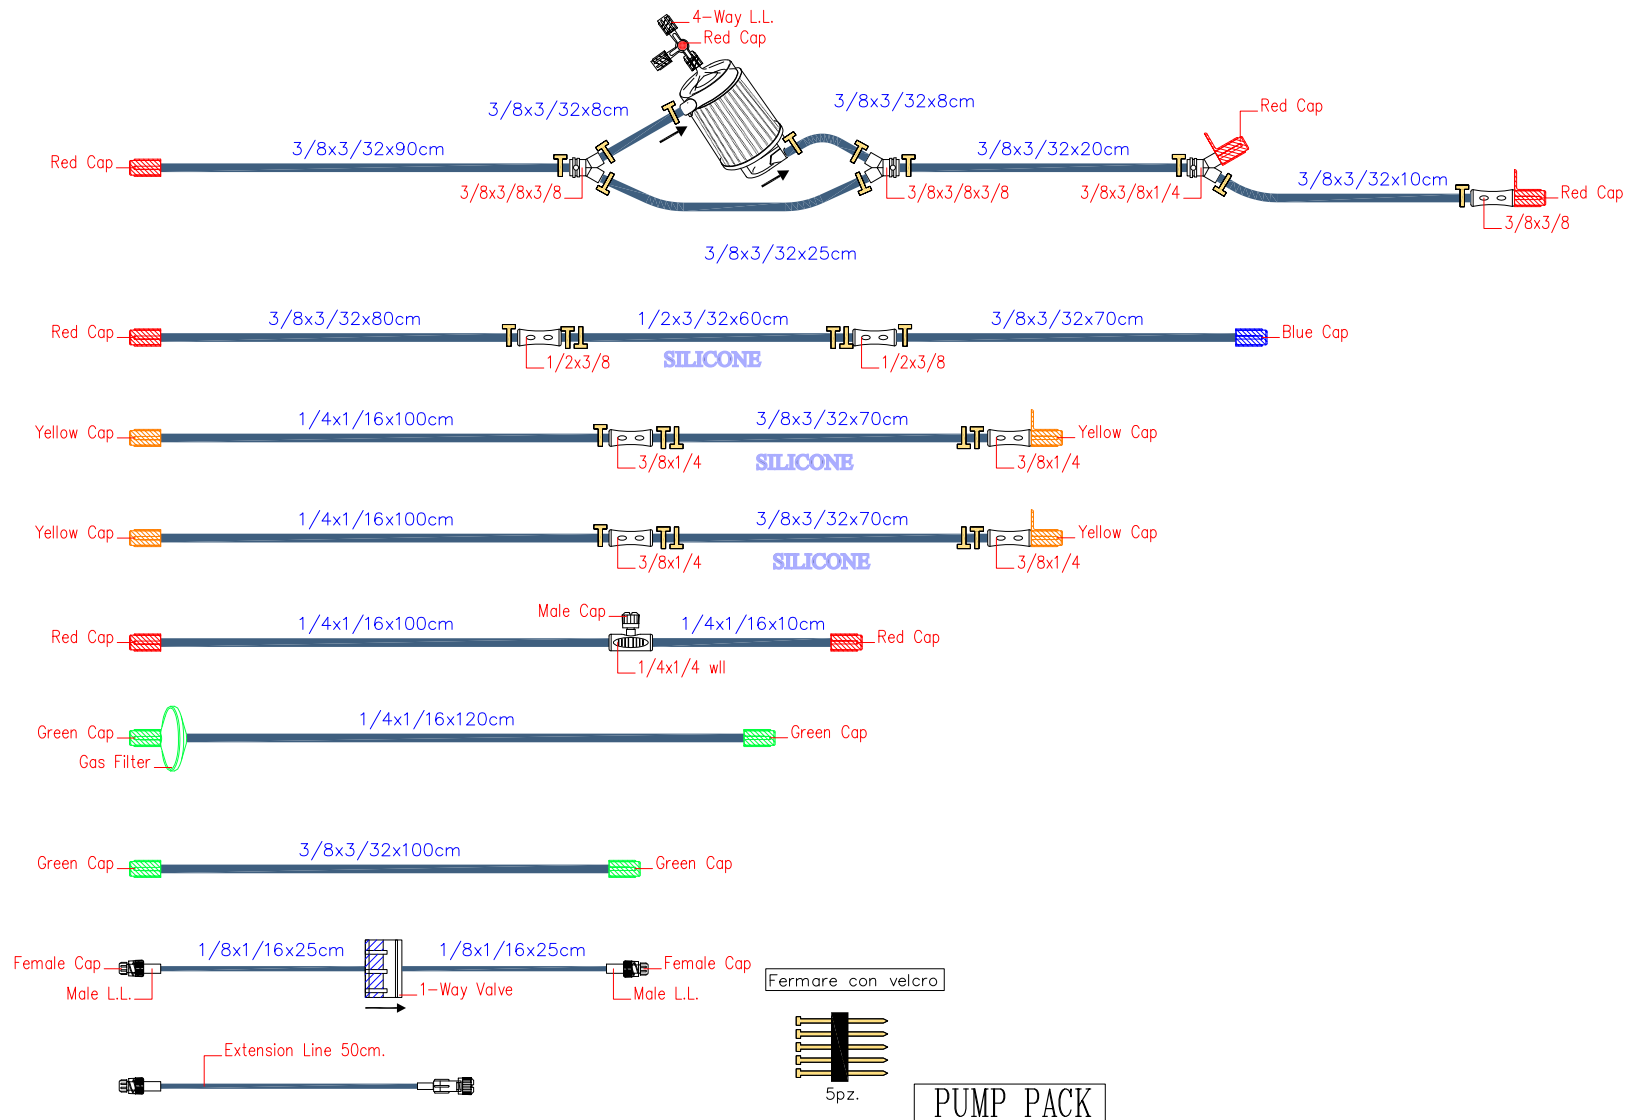

PACKAGING:



Perfusion Tubing Systems

INSTITUTE OF CARDIOVASCULAR
DISEASES VOJODINA
Sremska Kamenica, Republic of SERBIA